

BladderScan® 結果

0570-0190 | 00004196 | 1015023

檢查日期和時間: 7/07/10 2:46 下午

尿液量: 129 ml


病人身份:

性別: 

病人姓名:

操作人員:

醫生:

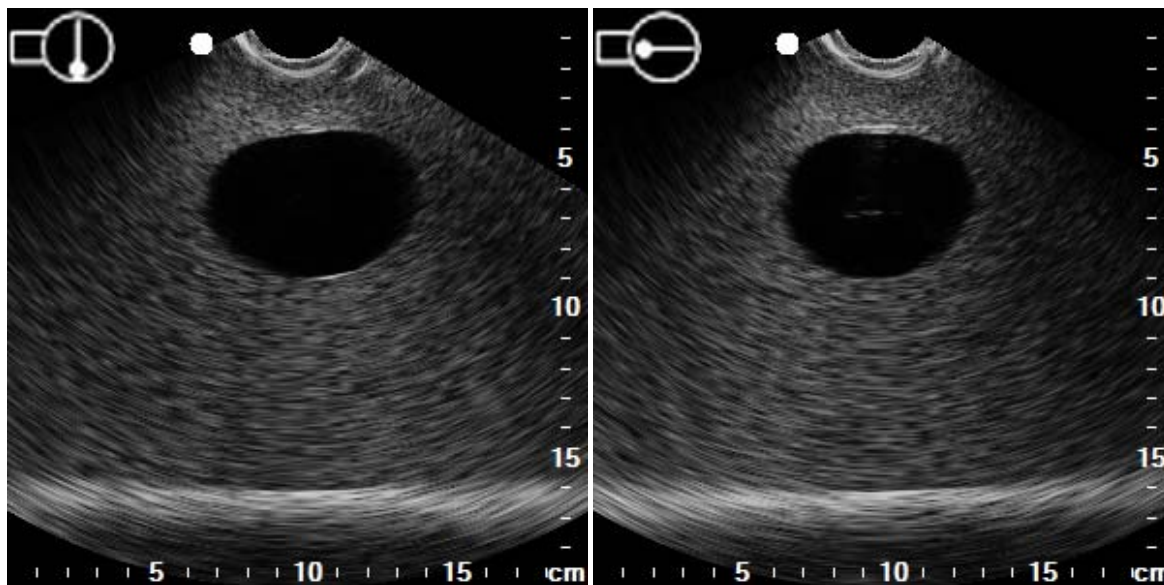

醫生簽名: _____